

Кыргызстандарт	Каракольский ЦИСМ Отдел ОЕИ	области аккредитации АККРЕДИТАЦИЯЛОО ЧӨЙРӨСҮ	Ф.КЦА-ПА100С.Г.2
	Караколдогу ССМБ ОБК белуму		

Одобрен Т.А. Стенда №3
Т.А. Садыр А.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КЦА А.Т.Ахмеджанова
М.П. подпись расшифровка подписи
Приложение к аттестату аккредитации
№ КГ417/КЦА.ОК 122
« 12 » 03 2025 г.
переворачивается 29.05.26 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений

Отдела ОЕИ Каракольского центра испытаний, сертификации и метрологии

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020 тип А

Схема/ы поверки СИ/аттестации оборудования: ПП КР 446 от 02.09.2019 , КМС Р8.568:2023г.

№ п/п	Наименование поверяемых средств измерений	Измеряемая величина	Диапазон измерений	Класс точности/погрешность	Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка	Место проведения поверки*
1	2	3	4	5	6	7

Измерения массы

1	Масса	Весы для статического взвешивание	до 10 кг 600 кг	КТ I, II КТ I....III	ГОСТ OIML R-76-1-2	На территории заказчика
		Весы автомобильные	До 80000 кг			
		Дозаторы весовые автоматические дискретного действия	0,5...600 кг	КТ 1...2	ГОСТ 8.523-2014	На территории заказчика

Издание	3	Дата введения	01. 10.2019	стр.	1 из 3
Базылышы		Киргизуу куну		Бети.	

Кыргызстандарт	Каракольский ЦИСМ Отдел ОЕИ	области аккредитации АККРЕДИТАЦИЯ ЛОО ЧӨЙРӨСҮ	Ф.КЦА-ПА10ОС.Г.2
	Караколдогу ССМБ ӨБК бөлүмү		



ДОПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ
органа контроля по проведению поверки средств измерений
Отдела ОЕИ Каракольского центра испытаний, сертификации и метрологии

наименование Органа контроля и организации заявителя

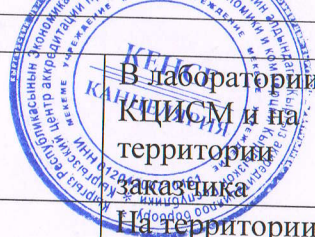
Тип органа контроля по ISO/IEC 17020 тип А

Схема/ы поверки СИ/аттестации оборудования: ПП КР 446 от 02.09.2019 , КМС Р8.568:2023г.

№ п/п	Наименование поверяемых средств измерений	Измеряемая величина	Диапазон измерений	Класс точности/погрешность	Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка	Место проведения поверки*
1	2	3	4	5	6	7
Измерения давления						
1.	Давления	Манометры технические	0,1...600кгс/см ²	КТ 0,6...4,0	ГОСТ 8.092-73 ГОСТ 2405-88 МИ 2124-90	В лаборатории КЦИСМ и на территории заказчика
2.	Давления	Сфигмоманометры	0...300мм. рт. ст.	ПГ±3мм. рт. ст.	Р1323565.2.001-2018	В лаборатории КЦИСМ и на территории заказчика
Измерения параметров потока, расхода , объема веществ						
3	Колонки топливораздаточные	Объем, дм ³ Расход, л/мин	2.....99999дм Расход5...50л/мин	ПГ0,25...1 %	1.ГОСТ 1864-20. 2.ГОСТ Р 58927:2026 3.МП21666-06 4.МП.ЛПА-9999.022.Д22 5.МП техн.017.000.00ПМ	На территории заказчика

Издание	3	Дата введения	01. 10.2019	стр.	2 из 3
Басылышы		Киргизуу куну		Бети.	


Кыргызстандарт	Каракольский ЦИСМ Отдел ОЕИ	области аккредитации АККРЕДИТАЦИЯЛОО ЧӨЙРӨСҮ	Ф.КЦА-ПА10ОС.Г.2
	Караколдогу ССМБ ӨБК белуму		

4	Водосчётчиков всех типов	Измерения потока расхода	от 0,03 до 3.0 м³/час	КТ 1,5...4	ГОСТ 8. 156-83 ГОСТ 1598	
5	Резервуары горизонтальные цилиндрические	Градировка	4000...75000л	ПГ 0,3..1%	ГОСТ 8.346-2000	
Измерения электрических величин постоянном и переменном токе						
6	Счетчики электрической энергии переменного тока одно и трех фазные	Электрические измерения	0,025...100А 220/380 В 50Гц	КТ 0,5...1	ГОСТ 8.584-2004 ГОСТ 8.259-2004	В лаборатории КЦИСМ и в лаборатории НЭСК (ЦРПУ)
Аттестация испытательного оборудования						
7.	Шкаф электрический, Стерилизатор сухо воздушный, Термостат электрический,	Температура	0....300°C	ПГ 0,5...6° С	КМС ГОСТ Р.8.568:2023 Методики поверки и техническая документация на конкретное ИО.	На территории заказчика
				ПГ 0,2..0,5° С		
8.	Центрифуга лабораторная	об/мин	0....5000тыс.об/мин	ПГ ..10%		
9.	Морозильные камеры	температура	-25.....10°C	ПГ 2°C	КМС ГОСТ Р.8.568:2023 Методики поверки и техническая документация на конкретное ИО	На территории заказчика

Директор
Каракольского ЦИСМ


С.Р. Джентаев
расшифровка подписи

Зав. отдел ОЕИ
Каракольского ЦИСМ


подпись

К. Т. Кыргызбаев
расшифровка подписи

Примечания:

1. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи
2. Начиная со 2-го листа последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи руководства КЦА.
3. Каждая страница области аккредитации должна быть идентифицирована в соответствии с ISO/IEC 17020 и подписана руководителем организации и поверочной лабораторией

Издание	3	Дата введения	01. 10.2019	стр.	3 из 3
Басылышы		Киргизуу куну		Бети.	