

Кыргызстандарт	Каракольский ЦИСМ Отдел ОЕИ	области аккредитации АККРЕДИТАЦИЯ ЛОО ЧӨЙРӨСҮ	Ф.КЦА-ПА100С.Г.2
	Караколдогу ССМБ/ӨБК бөлүмү		

Одобрено Т.Т. Стелсман
от 18.05.2025



УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА А. Т. Ахмеджанова
М.П. подпись расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации
№ КГ417/КЦА.ОК 122

«12» 03 2025 г.
пересмотр 29.05.2026г.

ДОПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ
органа контроля по проведению поверки средств измерений
Отдела ОЕИ Каракольского центра испытаний, сертификации и метрологии
наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020 тип А
Схема/ы поверки СИ/аттестации оборудования: ПП КР 446 от 02.09.2019, КМС Р8.568:2023г.

№ п/п	Наименование поверяемых средств измерений	Измеряемая величина	Диапазон измерений	Класс точности/погрешность	Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка	Место проведения поверки*
1	2	3	4	5	6	7
Измерения давления						
1.	Давления	Манометры технические	0,1...600кгс/см ²	КТ 0,6...4,0	ГОСТ 8.092-73 ГОСТ 2405-88 МИ 2124-90	В лаборатории КЦИСМ и на территории заказчика


№ издания	2	Дата введения	стр. 1 из 3
-----------	---	---------------	-------------

Кыргызстандарт	Каракольский ЦИСМ Отдел ОЕИ	области аккредитации АККРЕДИТАЦИЯ ЛОО ЧӨЙРӨСҮ	Ф.КЦА-ПА100С.Г.2
	Караколдогу ССМБ ОБК бөлүмү		

Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.ОК

« 12 » 05 2025 г.

перенесено

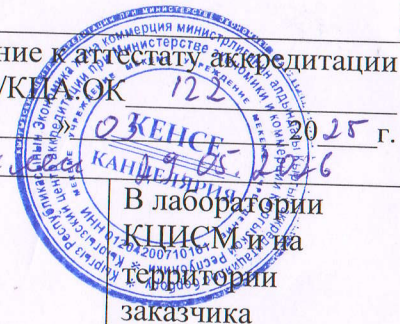

В лаборатории
КЦИСМ и на
территории
заказчика

2.	Давления	Сфигмоманометры	0...300мм. рт. ст.	ПГ±3мм. рт. ст.	P1323565.2.001-2018	
Измерения параметров потока, расхода, объема веществ						
3	Колонки топливораздаточные	Объем, дм ³ Расход, л/мин	2.....99999дм ³ Расход 5...50л/мин	ПГ 0,25... 1%	1.ГОСТ 1864-20. 2.ГОСТ Р 58927:2026 3.МПИ 21666-06 4.МПИ.ЛПА-9999.022.Д22 5.МПИ техн.017.000.00ПМ	На территории заказчика
4	Водосчётчиков всех типов	Измерения потока расхода	от 0,03 до 3.0 м ³ /час	КТ 1,5...4	ГОСТ 8. 156-83 ГОСТ 1598	В лаборатории КЦИСМ и на территории заказчика
5	Резервуары горизонтальные цилиндрические	Градировка	4000...75000л	ПГ 0,3..1%	ГОСТ 8.346-2000	На территории заказчика
Измерения электрических величин постоянном и переменном токе						
6	Счетчики электрической энергии переменного тока одно и трех фазные	Электрические измерения	0,025...100А 220/380 В 50Гц	КТ 0,5...1	ГОСТ 8.584-2004 ГОСТ 8.259-2004	В лаборатории КЦИСМ и в лаборатории НЭСК (ЦРПУ)
Аттестация испытательного оборудования						
7.	Шкаф электрический, Стерилизатор сухо	Температура	0....300°C	ПГ 0,5...6°C	КМС ГОСТ Р.8.568:2023 Методики поверки и техническая документация	На территории заказчика

Издание	3	Дата введения	01. 10.2019	стр.	2 из 3
Басылышы		Киргизуу куну		Бети.	

Кыргызстандарт	Каракольский ЦИСМ Отдел ОЕИ	области аккредитации АККРЕДИТАЦИЯ ЛОО ЧӨЙРӨСҮ	Ф.КЦА-ПА100С.Г2
	Караколдогу ССМБ ӨБК белуму		

Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.ОК 122

« 12 » 03 2025 г.

пересмотр - 29.05.2028

	воздушный, Термостат электрический			ПГ0,2..0,5°C	на конкретное ИО.	
8.	Центрифуга лабораторная	Об./мин	0....5000 тыс.об/мин	ПГ..10%	КМС ГОСТ Р.8.568:2023 Методики поверки и техническая документация на конкретное ИО	
9.	Морозильные камеры	температура	-25.....10°C	ПГ2°C	КМС ГОСТ Р.8.568:2023 Методики поверки и техническая документация на конкретное ИО	
						На территории заказчика

Директор
Каракольского ЦИСМ



С.Р. Джентаев
расшифровка подписи

Зав. отдел ОЕИ
Каракольского ЦИСМ

[Signature]
подпись

К. Т. Кыргызбаев
расшифровка подписи

Примечания:

1. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи
2. Начиная со 2-го листа последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи руководства КЦА.
3. Каждая страница области аккредитации должна быть идентифицирована в соответствии с ISO/IEC 17020 и подписана руководителем организации и поверочной лабораторией

Издание	3	Дата введения	01. 10.2019	стр.	3 из 3
Басылышы		Киргизуу куну		Бети.	